




**COMPARAISON DE MAINTENANCE ENTRE  
UNE BUSE D'ATOMISATION TECLINEA DF043  
ET UNE BUSE CONVENTIONNELLE**

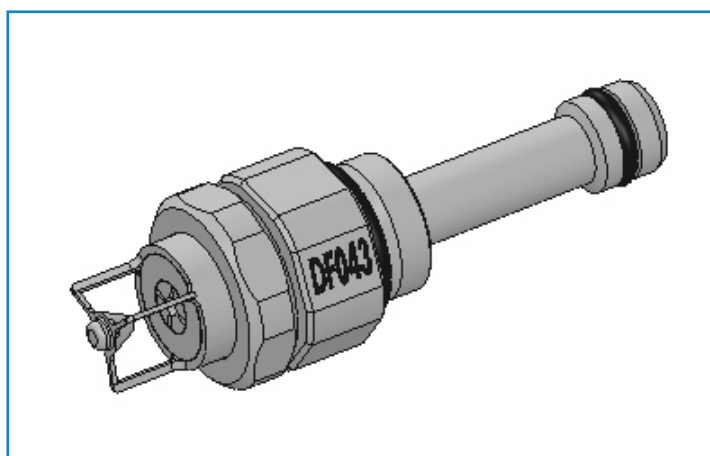


**BUSE DF043**

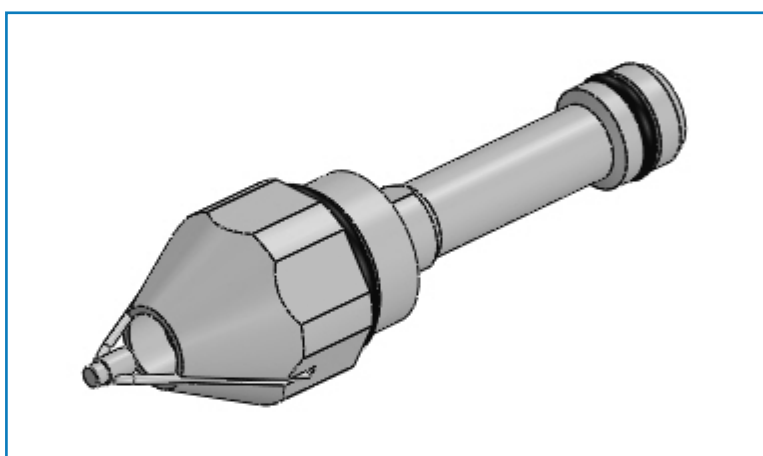

**BUSE CONVENTIONNELLE**

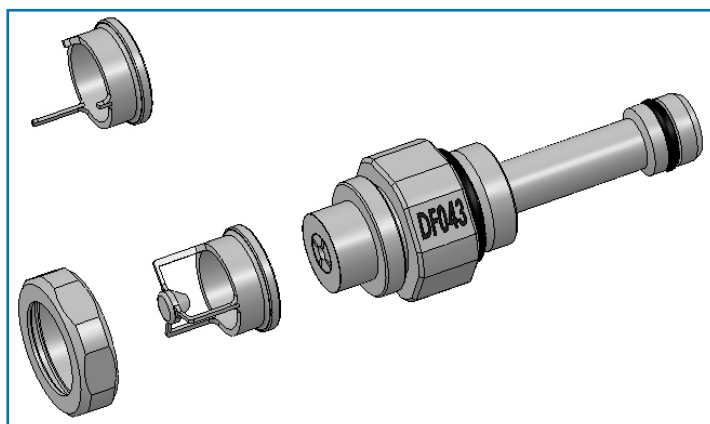

**REPLACEMENT DU RESONATEUR**

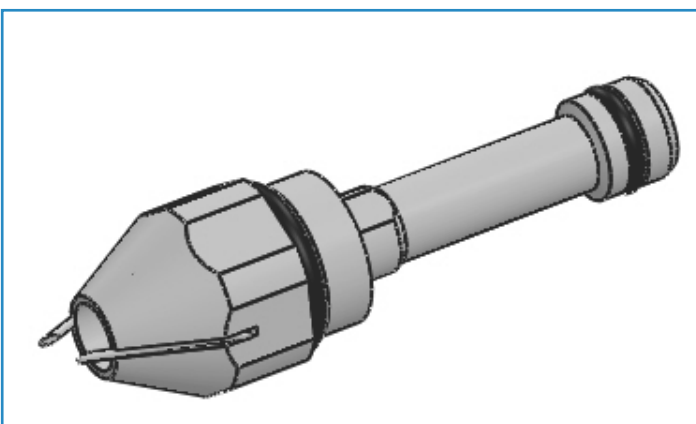

**BUSE IRREPARABLE**